

Solus® OA Plus Brace

OA SCHIENE, einfach, aufrecht

SUPPORTO PER OSTEOARTRITE singolo verticale

ORTHESE OA droite simple

RODILLERA PARA OSTEOARTRÍTIS (OA) sencilla recta



Breg, Inc.

2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.

P: 800-321-0607

F: 800-329-2734

www.breg.com




© 2013 Breg, Inc.

AW-1.00573 Rev A 0713



EC REP

E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

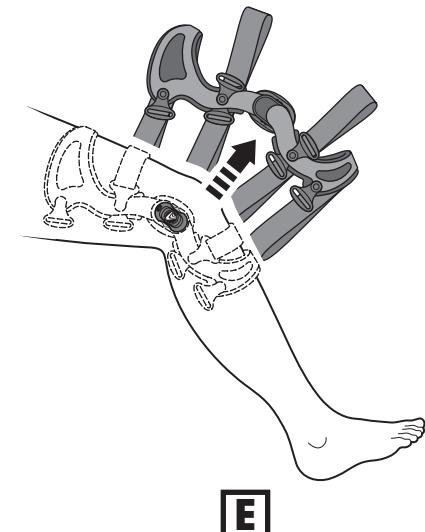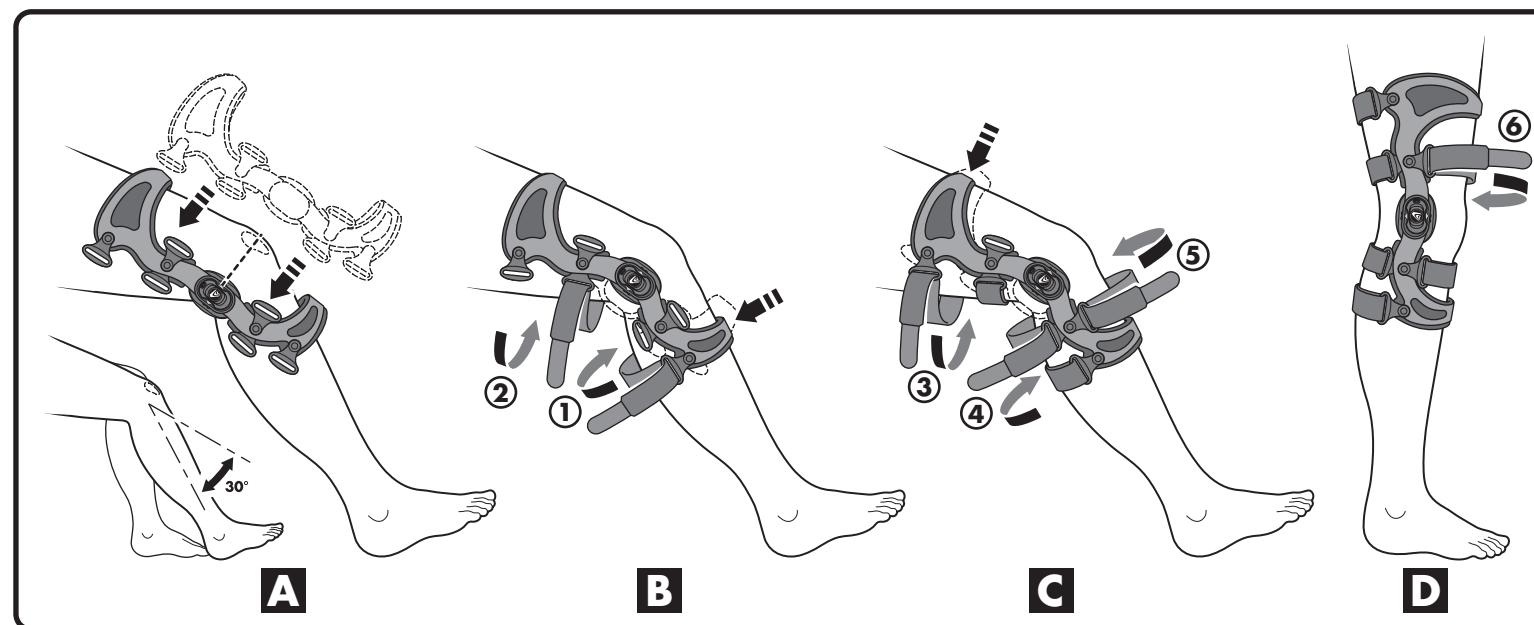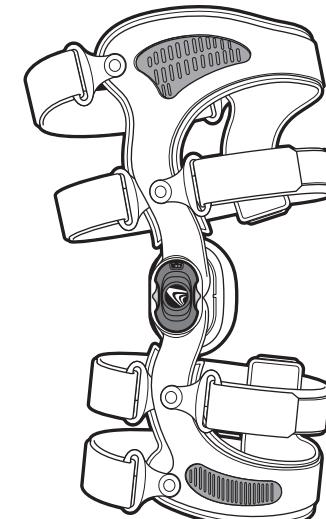

WARNINGS

WARNING: CAREFULLY READ FITTING INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO USE. TO ENSURE PROPER PERFORMANCE OF THE BRACE, FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO PROPERLY POSITION THE BRACE AND FASTEN EACH STRAP WILL COMPROMISE PERFORMANCE AND COMFORT.

WARNING: IF YOU EXPERIENCE INCREASED PAIN, SWELLING, SKIN IRRITATION, OR ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT, IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.

WARNING: THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER REHABILITATION AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM. CONSULT YOUR LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL REGARDING SAFE AND APPROPRIATE ACTIVITY LEVEL WHILE WEARING THIS DEVICE.

WARNING: FOR SLIDING ACTIVITIES, IT IS RECOMMENDED THAT A SLIDE GUARD (PN.22000, 22001) BE WORN WITH THE BRACE. WEARING A SLIDE GUARD IS INTENDED TO MINIMIZE IMPACT TO THE BRACE. THE SLIDE GUARD MAY NOT BE EFFECTIVE IN ALL SITUATIONS.

CAUTION: CARE AND CLEANING OF THIS PRODUCT IS ESSENTIAL TO ITS CONTINUING STRENGTH AND PERFORMANCE. FOLLOW REMOVAL AND CLEANING PROCESS DESCRIBED IN INSTRUCTIONS.

CAUTION: WHEN USING A SOLUS BRACE EQUIPPED WITH THE OA HINGE IT IS IMPORTANT TO KEEP DIRT AND Grit OUT OF THE HINGE MECHANISM TO MAINTAIN PROPER HINGE MOBILITY AND BRACE FUNCTION.

CAUTION: FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

Instructions for the SOLUS Single Upright OA Brace APPLY BRACE TO LEG

A. Unfasten all 6 straps and fold the hook/loop tabs back against the straps. Sit with the knee bent at a 30° angle. With the brace fully extended slide it onto the leg. Be sure that the hinge is on the lateral (outside) side of the knee.

Position the brace so that the center of the hinge aligns with the center of the patella.

Notice that the hinge may be positioned behind the bent knee, this is normal. As each strap is fastened, the hinge will move forward slightly, until the brace is properly positioned on the leg.

B. With the brace on the leg, press the rigid shin cuff on the front of the brace flat against the leg and fasten strap 1 behind the calf. Next, fasten strap 2 in the back above the knee.

C. Be sure that the rigid thigh cuff on the front of the brace is pressed flat against the leg and fasten strap 3, behind the hamstring. Next, fasten strap 4 in the back below the knee; then fasten strap 5 in the front below knee. Be sure to fasten all of the straps in the proper order.

D. Stand to fasten strap 6 in front above the knee.

Tighten the straps snugly, but comfortably. After 15 minutes of activity, sit with the knee bent at a 30° angle. Loosen and then retighten each strap, one at a time, in the proper order (this is necessary due to tissue swelling and compression). During this process, be sure the brace hinge aligns with the center of the patella. (See Figure A)

Improper strapping technique could result in discomfort. If you feel pressure on the thigh or shin, stand up straight and loosen the straps slightly. Press the rigid cuffs flat against the front of the thigh and shin, then retighten all the straps.

E. To remove the brace, unfasten all the straps (1 through 6) and remove the brace. Fold the hook/loop tabs back against the straps for easy storage or reapplication of brace.

WARNHINWEISE

WARNING: VOR DEM GEBAUCH SORGFALTIG ALLE ANLEITUNGEN ZUM ANLEGEN SOWIE DIE WARNUNGEN LESEN. ALLE ANWEISUNGEN BEACHTEN UND SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SCHIENE RICHTIG FUNKTIONIERT. WENN DIE SCHIENE NICHT VON SICHERHEITSMÄSIS ANGELEGT UND ALLE GURTE RICHTIG FESTGEZOGEN WERDEN, SO IST MIT EINER BEINTRÄGCHIGUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND DES TRÄGERCOMFORTS ZU RECHNET.

WARNING: DIESES PRODUKT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ANGEMESSENE REHABILITATION UND MODIFIZIERUNG DER AKTIVITÄTEN SIND EINERLÄSSLICHER BESTANDTEIL EINES SICHEREN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. SPRECHEN SIE MIT IHREN ARZT/PRAKTIKER ÜBER DEN GEFAHRLOSEN UND ANGEMESSENEN AKTIVITÄTSGRAD WÄHREND DES TRÄGENS DIESER SCHIENE.

WARNING: BEI AKTIVITÄTEN WIRD RUTSCHGEFAHR MÖGLICH. EMPFOHLEN, ZUSAMMEN MIT DER SCHIENE EINE ANTI-RUTSCHVORRICHTUNG (BESTELL-NR. 22000, 22001) ANZULEGEN. DAS TRAGEN EINER ANTI-RUTSCHVORRICHTUNG SOLL DIE SCHIENE GEGEN STOßEINWIRKUNG ABSICHERN. DIE ANTI-RUTSCHVORRICHTUNG IST NICHT IMMER IN ALLEN SITUATIONEN WIRKSAM.

ACHTUNG: DAS HALTBARKEIT UND FUNKTIONS-FÄHIGKEIT DIESES PRODUKTS ERFORDET SACHGEMÄSSE PFLEGE UND REHABILITATION.

ACHTUNG: BEI BEIDSEITIGER VERWENDUNG VON SCHENKEN SIND DIE AKTIVITÄTEN SOZU MODIFIZIEREN, DASS DIE SCHARNIER AN DEN INNERENSEITEN EINANDER NICHT BERÜHREN.

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINER MIT DEM OSTEOARTHRITIS-SCHARNIER AUSGETATENEN FUSIONSSCHIENE IST ES WICHTIG, DASS KEIN SCHMIDT UND KEINE STAUBKÖRNCHEN IN DEN SCHARNIERMECHANISMUS EINDRINGEN, UM DIE SCHARNIERBEWEGLICHKEIT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SCHIENE ZU GEWÄHRLEISTEN.

ACHTUNG: NUR FÜR EINZELNEN PATIENTEN VERWENDEN.

Anleitung für die SOLUS OA Schiene, einfach aufrecht ANLEGEN DER SCHIENE AM BEIN

A. Die 6 Gurte öffnen und die Klettflaschen zu den Gurten hin umschlagen. Mit dem Knie im 30°-Winkel gebeugt sitzen. Die Schiene vollständig ausdehnen und auf das Bein schieben. Sicherstellen, dass sich das Scharnier an der lateralen (außen) Seite des Knees befindet.

Die Schiene so positionieren, dass die Mitte des Scharniers an der Mitte der Knie scheibe ausgerichtet ist.

Wenn Sie bemerken, dass das Scharnier hinter dem gebeugten Knie positioniert ist, ist dies normal. Beim Anziehen der einzelnen Gurte bewegt sich das Scharnier leicht nach vorn, bis die Schiene in der richtigen Position am Bein anliegt.

B. Mit angelegter Schiene die an der Vorderseite der Schiene befindliche starre Schienbeinmanschette flach gegen das Bein drücken und Gurt 1 hinter der Wade anziehen. Dann Gurt 2 hinten oberhalb des Knie anziehen.

C. Sicherstellen, dass die starre Schenkelmanschette an der Vorderseite flach ans Bein gedrückt ist, und dann Gurt 3 hinter der Oberschenkelrückseite anziehen. Danach Gurt 4 an der Rückseite unter dem Knie festziehen; dann Gurt 5 an der Vorderseite unter dem Knie anziehen. Achten Sie darauf, alle Gurte in der richtigen Reihenfolge zu befestigen.

D. Gurt 6 im Stehen vorn oberhalb des Knie befestigen.

Die Gurte so fest anziehen, dass sie zwar sicher, aber noch bequem sitzen. Nach 15 Minuten Aktivität mit dem Knie im 30°-Winkel gebeugt sitzen. Die Gurte einzeln nacheinander in der richtigen Reihenfolge lockern und wieder anziehen (notwendig wegen Gewebebeschwellung und Kompression). Hierbei darf auf achten, dass das Scharnier der Schiene an der Mitte der Knie scheibe ausgerichtet ist (siehe Abb. A).

Falsche Gurtbefestigung kann zu Beschwerden führen. Falls Sie am Schenkel oder Schienbein Druck verspüren, gerade stehen und die Gurte ein wenig lockern. Die starren Manschetten vorn an Schenkel und Schienbein flach andrücken und dann alle Gurte wieder festziehen.

E. Zum Entfernen der Schiene alle Gurte (1 bis 6) lösen und die Schiene abnehmen. Die Klettflaschen zu den Gurten hin umschlagen, um die Schiene aufzubewahren bzw. später wieder anzulegen.

AVVERTENZE

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTIVAMENTE LE INSTRUZIONI PER LA MISE EN PLACE E LE MISSE EN GARDE AVANT USO. SUVEZ TUTTE LE INSTRUZIONI AFIN D'ASSURER UNE PERFORMANCE ADEQUATE DE L'ORTHESE. LA PERFORMANCE ET LE CONFORT SERONT COMPROMIS SI L'ORTHESE N'EST PAS PLACEE CORRECTEMENT ET SI TOUS LES SANGLES NE SONT PAS ATTACHEES.

AVVERTENZA: SE DURANTE L'USO SI ACCUSA AUMENTO DI DOLORE, D'ENFLURE, IRITAZIONE CUTANEA O QUALUNQUE ALTRA REAZIONE AVERSA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO OPERATORE SANITARIO.

AVVERTENZA: QUESTO DISPOSITIVO NON PREVENE DI RIDUCE alcuna LESIONE. PARTE ESSENZIALE DI UN PROGRAMMA TERAPETICO SICURO SONO ANCHE UNA RIABILITAZIONE ADEGUATA E LA MODIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. CONSULTEZ VOTRE PROPRIO OPERATORE SANITARIO ABILITATO IN RELAZIONE AL LIVELLO DI ATTIVITÀ SICURO E APPROPRIATO MENTRE SI INDOSSA QUESTO DISPOSITIVO.

AVVERTENZA: PER ATTIVITÀ CHE RICHIEDA SCIVOLATE, SI RACCOMANDA DI INDOSARE CON IL SUPPORTO UN APPOSITO COPRISUPPORTO PER SCIVOLATE (NUMERO DI CATALOGO 22000, 22001), ALLO SCOPO DI RIDURRE AL MINIMO LE SCELLEZIONI ESEZIATE SUL SUPPORTO STESSO. IL COPRISUPPORTO POTREBBE NON ESSERE EFFICACE IN TUTTE LE SITUAZIONI.

ATTENZIONE: LA CURA E LA PUZZIA DI QUESTO PRODOTTO SONO ESSENZIALI PER MANUTENERE SOLIDO ED IN BUONE CONDIZIONI OPERATIVE. SEGURARE IL PROCESSO DI RIMOCIONE E PUZZIA DESCRITTO NELLEISTRUZIONI.

ATTENZIONE: QUANDO SI USA IL SUPPORTO BILATERALMENTE, MODIFICARE L'ATTIVITÀ SECONDO LE NECESSITÀ PER EVITARE CHE LE CERNIERE MEDIALI SI TOCCINO.

ATTENZIONE: QUANDO SI USA UN SUPPORTO FUSION DOTATO DI CERNIERA DA OSTEOARTROSIS, È IMPORTANTE TENERE SPORCO E RESIDUI FUORI DAL MECANISMO DELLA CERNIERA, PER MANTENERE ADEGUATE FUNZIONALITÀ DEL SUPPORTO E MOBILITÀ DELLA CERNIERA.

ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE PER UN SINGOLO PATIENTE.

Istruzioni per il supporto per osteoartrite singolo verticale SOLUS APPLICAZIONE DEL SUPPORTO SULLA GAMBA

A. Slacciare tutti e 6 i cinturini e ripiegare all'indietro le linguette a strappo ad asola e uncino contro di essi. Sedersi con il ginocchio piegato a un angolo di 30°. Far scivolare l'ortese completamente esteso sulla gamba. Assicurarsi che la cerniera si trovi lateralmente (all'esterno) rispetto al ginocchio.

Posizionare il supporto in modo che il centro della cerniera sia allineato al centro della patella.

Notare che la cerniera può restare posizionata dietro il ginocchio piegato: ciò è normale. Man mano che si chiude ciascun cinturino, la cerniera si sposta leggermente in avanti, finché il supporto non risulta posizionato correttamente sulla gamba.

B. Con il supporto sulla gamba, premere il manicotto rigido della cresta tibiale, situato sulla parte anteriore del supporto, in modo che giaccia piatto contro lo stinco, e chiudere il cinturino 1 dietro il polpaccio. Quindi, chiudere il cinturino 2 sul retro, sopra il ginocchio.

C. Assicurarsi che il manicotto rigido della coscia, ubicato sulla parte anteriore del supporto, sia premuto piatto contro la gamba, quindi chiudere il cinturino 3, avvolgendo il muscolo femorale. Continuare allacciando il cinturino 4 sulla parte posteriore, sotto il ginocchio, e quindi il cinturino 5 sulla parte anteriore, sotto il ginocchio. Assicurarsi di chiudere tutti i cinturini nell'ordine giusto.

D. Alzarsi in piedi per chiudere il cinturino 6 sulla parte anteriore, sopra il ginocchio.

Allacciare i cinturini in modo che risultino aderenti, ma comodi. Dopo 15 minuti di attività, sedersi con il ginocchio piegato a un angolo di 30°. Allentare e poi stringere di nuovo ogni cinturino, uno alla volta, nell'ordine giusto (questa operazione è necessaria per compensare il gonfiore e la compressione dei tessuti). Durante questa fase, assicurarsi che la cerniera del supporto sia in linea con il centro della patella (vedere la Figura A).

Una tecnica errata di chiusura dei cinturini può causare disagio al paziente. Se si percepisce pressione sulla coscia o sulla cresta tibiale, alzarsi in posizione eretta e allentare leggermente i cinturini. Premere i manicotti rigidi in modo che giacciono piatti contro la parte anteriore della coscia e della cresta tibiale e poi stringere di nuovo tutti i cinturini.

E. Per rimuovere il supporto, allentare tutti i cinturini (dall'1 al 6). Piegare all'indietro, contro i cinturini, le linguette a strappo, per comodità quando si ripone o si riapplica il supporto.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE ET LES MISES EN GARDE AVANT USAGE. SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AFIN D'ASSURER UNE PERFORMANCE ADEQUATE DE L'ORTHESE. LA PERFORMANCE ET LE CONFORT SERONT COMPROMIS SI L'ORTHESE N'EST PAS PLACEE CORRECTEMENT ET SI TOUS LES SANGLES NE SONT PAS ATTACHEES.

AVERTISSEMENT : EN CAS D'AUGMENTATION DE LA DOULEUR, D'ENFLURE, D'IRRITATION DE LA PEAU OU D'AUTRES REACTIONS AVERSAS, CONSULTER IMMEDIATEMENT LE PROPRIO OPERATEUR SANITARIO.

AVERTISSEMENT : CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À PREVENIR OU À REDUIRE TOUTES LES LESIONS. UNE REEDUCATION APPROPRIEE ET UN CHANGEMENT D'ACTIVITÉ FONT ÉGALEMENT PARTIE DES ELEMENTS ESSENTIELS À UN PROGRAMME DE TRAITEMENT REUSSI. CONSULTEZ VOTRE PROFESSIONNEL AUTORISÉ EN SANTE EN CE QUI CONCERNÉ LE NIVEAU D'ACTIVITÉ SUR ET APPROPRIÉ LORS DU PORT DE CE DISPOSITIF.

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDE DE PORTER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES GLISSÉMENTS (N° DE PIÈCE 22000, 22001) AVEC L'ORTHESE EN CAS D'ACTIVITÉS IMPLiquANT DES GLISSÉMENTS. LE PORT D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES GLISSÉMENTS EST DESTINÉ À REDUIRE L'IMPACT SUR L'ORTHESE. LE DISPOSITIF DE PROTECTION PEUT NE PAS ÊTRE EFFICACE DANS TOUTES LES SITUATIONS.

ATTENTION : LE SOIN ET LE NETTOYAGE APPORTÉS À CE PRODUIT SONT ESSENTIELS AU MISEN DE SA RÉSISTANCE ET DE SA PERFORMANCE. SUIVRE LE PROCÉDÉ D'ÉLAVEMENT ET DE NETTOYAGE DECIRITS DANS LES INSTRUCTIONS.

ATTENTION : SI LES ORTHÈSES SONT EMPLOYÉES DE MANIÈRE BILATERALE, MODIFIEZ VOS ACTIVITÉS SELON LES BESOINS AFIN D'EMPêCHER LES ARTICULATIONS MEDIALES D'ENTRER EN CONTACT L'UNE AVEC L'AUTRE.

ATTENTION : LORS DE L'UTILISATION D'UNE ORTHÈSE FUSION MUNIE DE L'ARTICULATION POUR ARTHROSE, IL EST IMPORTANT D'EMPêCHER TOUTE PENETRATION DE SALETÉ ET DE POUDRE DANS LE MÉCANISME DE L'ARTICULATION AFIN DE MAINTENIR LA MOBILITÉ DE CELLE-CI AINSI QUE LA FONCTION DE L'ORTHESE.

ATTENTION : USAGE RESERVE A UN SEUL PATIENT.

Instructions pour l'orthèse OA droite simple SOLUS APPLICATION DE L'ORTHESE SUR LA JAMBÉ

A. Détachez les 6 sangles et repliez les pattes fermeture auto-adhesive contre les sangles. Asseyez-vous avec le genou plié à un angle de 30°. Faites glisser l'orthèse entièrement étendue le long de la jambe. Assurez-vous que l'articulation se trouve sur le côté latéral (extérieur) du genou.


Placez l'orthèse de manière à ce que le centre de l'articulation soit aligné sur le centre de la rotule.

Veuillez noter qu'il est possible que l'articulation soit placée à l'arrière du genou replié ; ceci est normal. Lorsque vous attachez chacune des sangles, l'articulation se déplace légèrement vers l'avant, jusqu'à ce que l'orthèse soit bien placée sur la jambe.

B. Avec l'orthèse sur la jambe, appuyez la bande rigide du tibia sur l'avant de l'orthèse à plat contre la jambe, et attachez la sangle 1 à l'arrière du mollet. Attachez ensuite la sangle 2 à l'arrière, au-dessus du genou.

C. Assurez-vous que la bande rigide de la cuisse située à l'avant de l'orthèse est appuyée à plat contre la jambe et attachez la sangle 3, à l'arrière du jarret. Attachez ensuite la sangle 4 à l'arrière, sous le genou ; puis attachez la sangle 5 à l'avant, sous le genou. Assurez-vous d'attacher toutes les sangles dans l'ordre approprié.

D. Mettez-vous debout pour attacher la sangle 6 à l'avant, au-dessus du genou.

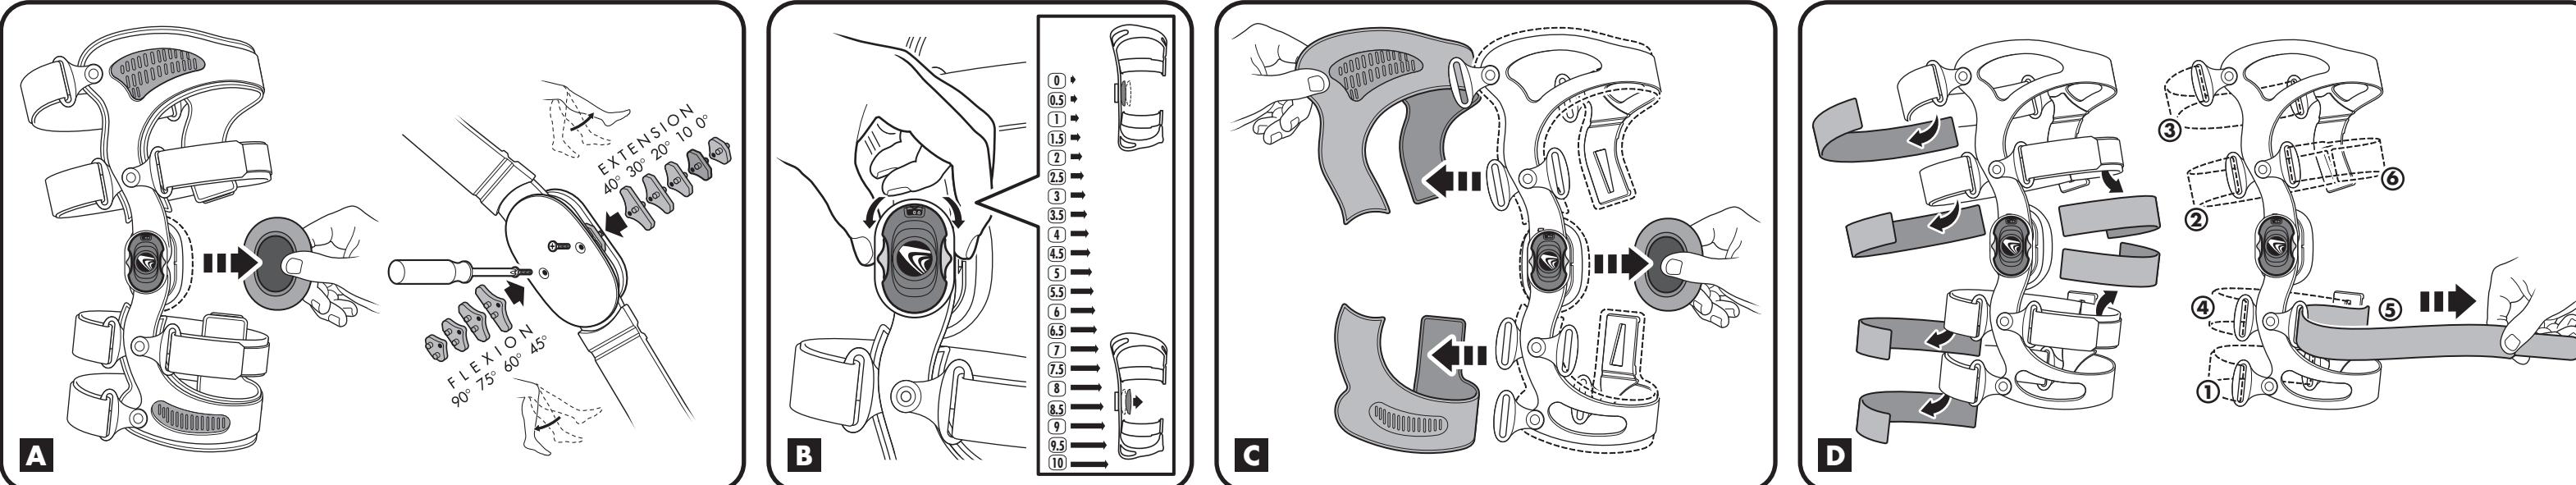

HINGE RANGE OF MOTION ADJUSTMENT

A. Brace is shipped with 10° hinge extension stops installed with additional flexion and extension stops in box. Stops are labeled in degrees:

Extension stops: 0°, 10°, 20°, 30° & 40°

Flexion stops: 45°, 60°, 75° & 90°

(brace is shipped with no flexion stops installed)

To change hinge stops, first remove the condyle pads held in place by hook/loop fasteners. Simply pull the pads off the hinge plate. To replace the pads be sure that they are positioned properly and firmly push them onto their hook/loop fasteners.

Next, use a screwdriver to remove screws. Remove existing stop, insert new stop, replace screw. Be sure that screws are seated and snug.

OSTEOARTHRITIS (OA) HINGE INSTRUCTIONS

B. With the brace properly applied and retightened, OA symptoms can be relieved by applying a lateral force to the outside of the knee by turning the circular dial (in the hinge) clockwise. With the knee bent in either a seated or standing position, you can easily turn the circular dial to move the condyle pad inward (toward knee). The window on the top edge of the hinge will display settings ranging from 0 to 10 in 0.5mm increments; the higher the number the greater the lateral force being applied. To reduce the lateral force, turn the dial counterclockwise to a lower setting.

CARE AND CLEANING

Straps and strap pads must be removed and cleaned regularly depending upon your activity level and perspiration. Hand wash straps and strap pads in cold water with mild detergent, rinse, AIR DRY. Occasionally apply a dry lubricant to hinge especially after use in water.

C. The frame pads are held in place by hook/loop fasteners. Carefully pull the pads off the brace frame. To replace the pads be sure that they are positioned properly and firmly push them onto their hook/loop fasteners.

The knee hinge condyle pad is held in place by hook/loop fasteners. Simply pull the pad off the hinge plate. To replace the pad be sure that it is positioned properly and firmly push it onto its hook/loop fastener.

D. To remove the brace straps, first remove the strap pads from the inside of the straps. Next, unfasten each strap. Then loosen the hook/loop tabs at the end of each strap and pull the strap free from the anchor point. Be sure to replace the straps according to their strap number locations. See illustration.

FITTING TIPS

Hold the brace hinge in position while fastening and tightening each strap. This will prevent the brace from rotating on the leg, keep the hinge slightly back on the knee and ensure the best possible fit and function.

Strap Length Adjustment: If a strap is too long or too short (preventing the numbered strap tab from properly adhering to the strap). First, remove the strap pad and unfasten the strap tab, then unfasten the "tail end" of the strap and slide the strap to either lengthen or shorten. Refasten the strap ends and replace the strap pads.

SCHARNIEREINSTELLUNG FÜR VERSCHIEDENE BEWEGUNGSGRADE

A. Bei Lieferung sind in der Schiene die 10°-Extensions-Stops installiert; außerdem sind im Paket zusätzliche Flexions- und Extensions-Stops enthalten. Die Stops sind mit den verschiedenen Winkeln gekennzeichnet:

Extensions-Stops: 0°, 10°, 20°, 30° und 40°

Flexions-Stops: 45°, 60°, 75° und 90°

(brace is shipped with no flexion stops installed)

Zum Ändern der Scharnierstoppes zunächst die Kondyluspölster abnehmen, die durch Klettlaschen festgehalten werden. Einfach die Polster von der Scharnierplatte abziehen. Beim erneuten Anbringen der Polster sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß positioniert sind, und dann fest auf die Klettlaschen drücken.

Dann die Schrauben mit einem Schraubenzieher entfernen. Vorhandenen Stopp entfernen, neuen Stopp einsetzen und Schraube wieder anziehen. Prüfen, ob die Schrauben richtig sitzen und fest angezogen sind.

ANLEITUNG FÜR OSTEOARTHRITIS-SCHARNIERE (OA)

B. Wenn die Schiene richtig angebracht und wieder festgezogen wurde, kann zur Linderung von Osteoarthritissymptomen lateraler Druck auf die Knieaußenseite ausgeübt werden, indem die (im Scharnier befindliche) runde Wähl scheibe im Uhrzeigersinn gedreht wird. Bei gebogenem Knie ist die runde Wähl scheibe in sitzender oder stehender Position leicht drehbar, wodurch das Kondylenpolster nach innen (zum Knie hin) bewegt wird. Das Fenster am oberen Rand des Scharniers zeigt Einstellungen von 0 bis 10 in 0,5-mm-Schritten; je höher die Zahl desto größer die laterale Druckeinwirkung. Um den seitlichen Druck zu reduzieren, durch Drehen der Scheibe gegen den Uhrzeigersinn eine niedrigere Einstellung wählen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Gurte und Gurtpolster müssen je nach Intensität der körperlichen Aktivitäten und des Schwitzens regelmäßig abgenommen und gereinigt werden. Gurte und Gurtpolster von Hand in kaltem Wasser mit einem milden Waschmittel waschen, spülen und AN DER LUFT TROCKNEN. Gelegentlich ein Trockenschmiermittel auf das Scharnier auftragen, besonders nach Kontakt mit Wasser.

C. Die Rahmenpolster werden von Klettlaschen festgehalten. Die Polster vorsichtig vom Schienengerüst abziehen. Beim erneuten Anbringen der Polster sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß positioniert sind, dann die Polster fest auf die Klettlaschen drücken.

Das Kondyluspölster der Kniestütze wird von Klettlaschen festgehalten. Einfach das Polster von der Scharnierplatte abziehen. Beim erneuten Anbringen des Polsters sicherstellen, dass dieses ordnungsgemäß positioniert ist, dann die Polster fest auf die entsprechende Klettlasche drücken.

D. Zum Entfernen der Schienengerüste zuerst die Gurtpolster von der Innenseite der Gurte entfernen. Dann alle Gurte lösen. Danach die am Ende jedes Gurtes befindlichen Klettlaschen lockern und den Gurt vom Verankerungspunkt abziehen. Achten Sie beim erneuten Anlegen darauf, die Gurte gemäß der jeweiligen Gurtnummernposition anzubringen (siehe Abbildung).

TIPS FÜR GUTEN SITZ

Halten Sie das Scharnier in Position, während Sie die einzelnen Gurte befestigen und anziehen. Dadurch wird ein Verdrehen der Kniestütze am Bein verhindert, das Scharnier leicht zur Kniekehle hin ausgerichtet und der Sitz und die Funktionsfähigkeit der Schiene optimiert.

Einstellen der Haltegurtlänge: Wenn ein Gurt zu lang oder zu kurz ist (sodass die nummerierte Gurtlasche nicht richtig am Gurt haften kann): Zuerst das Gurtpolster entfernen und die Gurtlasche lösen, dann das hintere Ende des Gurts lösen und den Gurt verschieben, um ihn entweder zu verlängern oder zu verkürzen. Gurtenden wieder fixieren und Gurtpolster wieder einsetzen.

REGOLAZIONE DEL RAGGIO DI MOVIMENTO DELLA CERNIERA

A. Il supporto viene spedito con installati dei fermi di estensione della cerniera a 10°, e con ulteriori fermi di flessione ed estensione in dotazione nella confezione. I fermi sono etichettati in gradi.

Fermi di estensione: 0°, 10°, 20°, 30° e 40°

Fermi di flessione: 45°, 60°, 75° e 90°

(Il supporto viene spedito senza fermi di flessione installati)

Per cambiare i fermi della cerniera, rimuovere innanzitutto i cuscini del condilo tenuti in posizione da elementi di fissaggio a strappo. Basta staccare i cuscini dalla piastra della cerniera. Per rimettere in posizione i cuscini, assicurarsi che essi siano posizionati correttamente e spingerli con fermezza sui loro elementi di fissaggio a strappo.

Poi, usare un cacciavite per rimuovere le viti. Rimuovere il fermo esistente, inserire uno nuovo e rimettere a posto le viti. Assicurarsi che le viti siano bene allargiate e serrate.

ISTRUZIONI PER LA CERNIERA PER OSTEOARTRITE (OA)

B. Con il supporto applicato correttamente e stretto di nuovo, i sintomi dolorosi dell'osteoartrite possono essere alleviati applicando una sollecitazione laterale all'esterno del ginocchio: a tale scopo, girare in senso orario il quadrante di regolazione circolare (sulla cerniera). Con il ginocchio piegato, stando seduti o in piedi, si può facilmente girare il quadrante di regolazione circolare per spostare verso l'interno (verso il ginocchio) il cuscinetto del condilo. La finestra sul margine superiore della cerniera mostra le impostazioni, che vanno da 0 a 10 mm, in incrementi di 0,5 mm; quanto più alto il numero, tanto maggiore la sollecitazione laterale che viene applicata. Per ridurre la sollecitazione laterale, girare il quadrante di regolazione in senso antiorario, su un'impostazione inferiore.

CURA E PULIZIA

I cinturini e i loro cuscini devono essere rimossi e lavati regolarmente, a seconda del livello di attività e traspirazione del paziente. Lavare a mano i cinturini e i loro cuscini in acqua fredda con detergente delicato, risciacquare e FAR E ASCIUGARE ALL'ARIA. Applicare di quando in quando un lubrificante secco, particolarmente dopo aver utilizzato nell'acqua.

C. I cuscini del telaio vengono tenuti in posizione da elementi di fissaggio a strappo. Staccare delicatamente i cuscini dal telaio del supporto. Per rimettere in posizione i cuscini, assicurarsi che essi siano posizionati correttamente e spingerli con fermezza sui loro elementi di fissaggio a strappo.

Il cuscinetto del condilo in corrispondenza della cerniera del ginocchio viene tenuto in posizione da un elemento di fissaggio a strappo. Basta staccare il cuscinetto dalla piastra della cerniera. Per rimetterlo in posizione, assicurarsi che sia posizionato correttamente e spingerlo con fermezza sul suo elemento di fissaggio a strappo.

D. Per rimuovere i cinturini del supporto, innanzitutto togliere i cuscini che si trovano all'interno dei cinturini stessi. Quindi aprire ciascun cinturino, allentare le lingue a strappo situate all'estremità e liberare il cinturino dal punto di ancoraggio. Assicurarsi di rimettere a posto i cinturini nelle posizioni corrispondenti ai loro numeri (vedere l'illustrazione).

CONSIGLI PER L'ADATTAMENTO DEL SUPPORTO

Tenere in posizione la cerniera del supporto mentre si chiude e si stringe ogni cinturino. In questo modo si impedisce che il supporto ruoti sulla gamba, si mantiene la cerniera leggermente indietro sul ginocchio e si assicurano l'adattamento e la funzionalità ottimali del supporto.

Regolazione della lunghezza dei cinturini: se un cinturino è troppo lungo o troppo corto (ed impedisce alla linguetta del cinturino numerato di aderire in modo adeguato al cinturino), innanzitutto rimuovere il cuscinetto del cinturino e aprire la linguetta, quindi aprire l'estremità del cinturino e far scorrere il cinturino stesso in modo da allungarlo o accorciarlo. Richiedere le estremità del cinturino e rimettere a posto i cuscini.

REGLAGE DE LA MOBILITÉ ARTICULAIRE

A. L'orthèse est fournie munie de butées d'extension d'articulation de 10° ; la boîte contient des butées de flexion et d'extension supplémentaires. Les butées sont marquées en degrés :

Butées d'extension : 0°, 10°, 20°, 30° & 40°

Butées de flexion : 45°, 60°, 75° & 90°

(les butées de flexion ne sont pas en place au moment de l'expédition)

Pour changer les butées d'articulation, enlevez d'abord les coussinets condiliens maintenus en place par des attaches à fermeture auto-adhesive. Retirez simplement les coussinets de la plaque d'articulation. Pour remettre les coussinets en place, veillez à ce qu'ils soient positionnés correctement et poussez-les fermement sur leurs attaches à fermeture auto-adhesive.

Ensuite, utilisez un tournevis pour retirer les vis. Retirez la butée existante, introduisez la nouvelle butée, puis remettez la vis en place. Vérifiez que les vis sont en place et bien serrées.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX ARTICULATIONS POUR ARTHROSE (OA)

B. Lorsque l'orthèse est appliquée correctement et serrée, les symptômes de douleurs dues aux arthroses peuvent être soulagés en appliquant une force latérale sur l'extérieur du genou et en tournant le bouton rotatif (dans l'articulation) dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec le genou replié en position assise ou debout, vous pouvez tourner le bouton rotatif sans difficulté pour déplacer le coussinet condilyen vers l'intérieur (vers le genou). La fenêtre située sur le bord supérieur de l'articulation affiche des réglages entre 0 et 10, en échelons de 0,5 mm ; plus le chiffre est élevé, plus la force latérale appliquée sera grande. Pour réduire la force latérale, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à un réglage plus bas.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirez et nettoyez régulièrement les sangles et les coussinets de sangle en fonction de votre niveau d'activité et de la transpiration. Lavez les sangles et les coussinetti de sangle à l'eau froide avec un détergent doux, rincez et LAISSEZ-LES SECHER A L'AIR. Appliquez de temps à autre un lubrifiant sec sur l'articulation, particulièrement après l'avoir utilisée dans l'eau.

C. Les coussinets d'armature sont maintenus en place par des attaches à fermeture auto-adhesive. Retirez soigneusement les coussinets de l'armature de l'orthèse. Pour remettre les coussinets en place, veillez à ce qu'ils soient positionnés correctement et poussez-les fermement sur leurs attaches à fermeture auto-adhesive.

Le coussinet condilyen de l'articulation du genou est maintenu en place par des attaches à fermeture auto-adhesive. Retirez simplement le coussinet de la plaque d'articulation. Pour remettre le coussinet en place, veillez à ce qu'il soit positionné correctement et poussez-le fermement sur son attache à fermeture auto-adhesive.

D. Pour retirer les sangles de l'orthèse, retirez d'abord les coussinets de sangle de l'intérieur des sangles. Ensuite, desserrez chaque sangle. Puis, desserrez les pattes à fermeture auto-adhesive à l'extrême de chaque sangle et détachez la sangle du point d'attache. Veillez à remettre les sangles en place selon leurs emplacements de numéro de sangle ; voir l'illustration.

CONSEILS DE MISE EN PLACE

Maintenez l'articulation de l'orthèse en place tout en attachant et en serrant chaque sangle. Ceci empêche l'orthèse de tourner sur la jambe, maintiendra l'articulation légèrement en arrière sur le genou permettant ainsi à l'orthèse d'épouser le genou et de remplir au mieux sa fonction.

Réglage de la longueur des sangles : si une sangle est trop longue ou trop courte (ce qui empêche la patte de sangle numérotée d'adhérer correctement à la sangle), commencez par retirer le coussinet de la sangle et desserrez la patte de celle-ci, puis desserrez « l'extrême en queue » de la sangle et faites glisser la sangle pour la rallonger ou la raccourcir. Réattachez les extrémités de la sangle et remettez les coussinets de celle-ci en place.

AJUDE DEL RADIO DE MOVIMIENTO DE LA BISAGRA

A. La rodillera viene con topes de extensión de la bisagra de 10° ya instalados y con topes adicionales de flexión y extensión en la caja. Los topes están marcados en grados:

Topes de extensión: 0°, 10°, 20°, 30° y 40°

Topes de flexión: 45°, 60°, 75° y 90°

(la rodillera se envía sin los topes de flexión instalados)

Para cambiar los topes de la bisagra, quite primero los acolchados de cóndilo asegurados por sujetadores de gancho/lazo. Simplemente saque los acolchados de la placa de la bisagra. Para volver a colocar los acolchados, asegúrese de que estén en la posición correcta y empújelos con firmeza en sus sujetadores de gancho/lazo.

A continuación, utilice un destornillador para quitar los tornillos. Quite el topo existente, introduzca el nuevo, vuelva a poner el tornillo. Asegúrese de que los tornillos estén bien colocados y apretados.

INSTRUCCIONES DE BISAGRAS PARA LA OSTEOARTRÍTIS (OA)

B. Con la rodillera colocada correctamente y bien apretada, los síntomas de dolor causados por la osteoartritis pueden aliviarse mediante la aplicación de una fuerza lateral en el exterior de la rodilla girando el cuadrante circular (de la bisagra) en el sentido de las agujas del reloj. Si está de pie o sentado, con la rodilla doblada, puede girar fácilmente el cuadrante circular para mover el acolchado del cóndilo hacia dentro (hacia la rodilla). La ventana en el borde superior de la bisagra mostrará valores del 0 al 10 en incrementos de 0,5 mm; cuanto mayor sea el número, mayor será la fuerza lateral que se está aplicando. Para reducir la fuerza lateral, gire el cuadrante en sentido contrario a las agujas del reloj a un valor inferior.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Las tiras y acolchados de las tiras deben quitarse y limpiarse regularmente dependiendo de su nivel de actividad y de la transpiración. Lave las tiras y los acolchados de las tiras a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelos y SÉQUELOS AL AIRE. De vez en cuando aplique un lubricante seco a la bisagra, especialmente después de llevar la rodillera puesta en agua.

C. Los acolchados de la estructura están asegurados por sujetadores de gancho/lazo. Tire con cuidado de los acolchados para sacarlos de la